# Distributeur de savon / S.H.A / Bétadine

Distributeur automatique rechargeable

**Commande électronique à piles**

**Recharge facile**

## Matériaux

Boitier en ABS Blanc

OPTION: Platine PVC Blanc pour clipser sur rail

**DESCRIPTIF**

Distributeur à commande électronique à piles.

Permet le lavage des mains sans contact avec l'appareil, pour un respect optimal des préconisations d'hygiène.

- Pompe à savon remplaçable
- Compatible tous types de savon.
- Volume de remplissage: 500ml
- Volume de dosage: 1,5ml / 3 ml / course
- Fixation directe au mur, ou sur rail Medical Process avec les platines PVC.

- Garantie 2 ans



MEDICAL PROCESS S.A.S.
211 av des carrières, Z.I la Plaine du Caire 3 - 13830 Roquefort la Bédoule - FRANCE

# Distributeur de savon / S.H.A / Bétadine

## Notice d'installation et d'entretien
## Commande Electronique

1a. Par défaut: Non verrouillé

Appuyer sur le bouton et ouvrir

1b: Sur demande, livré verrouillé

Utiliser la clé , puis appuyer sur le bouton et ouvrir

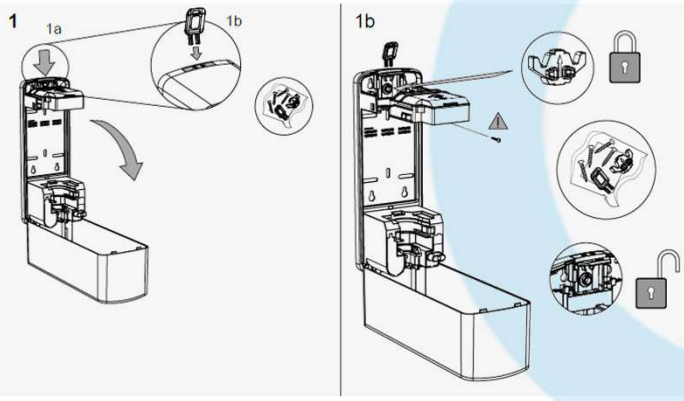


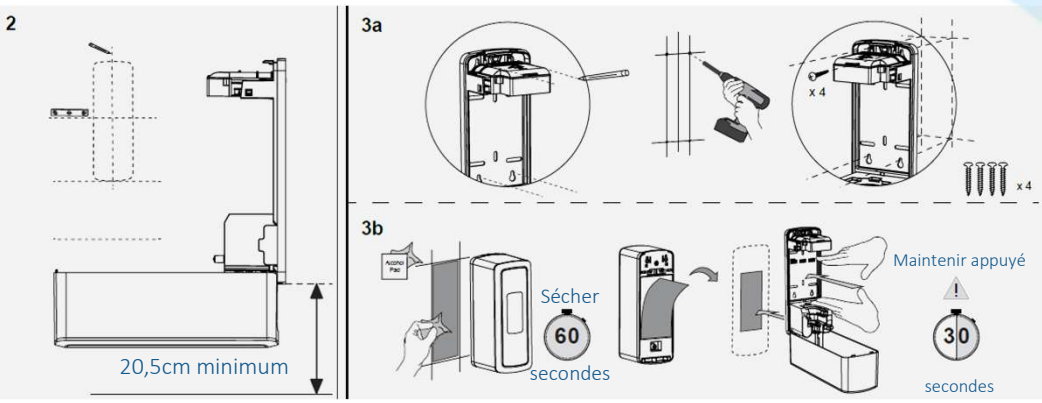


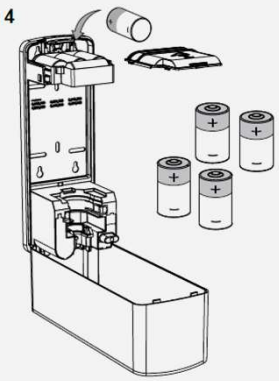


4 piles C

N'utiliser que des piles alkaline

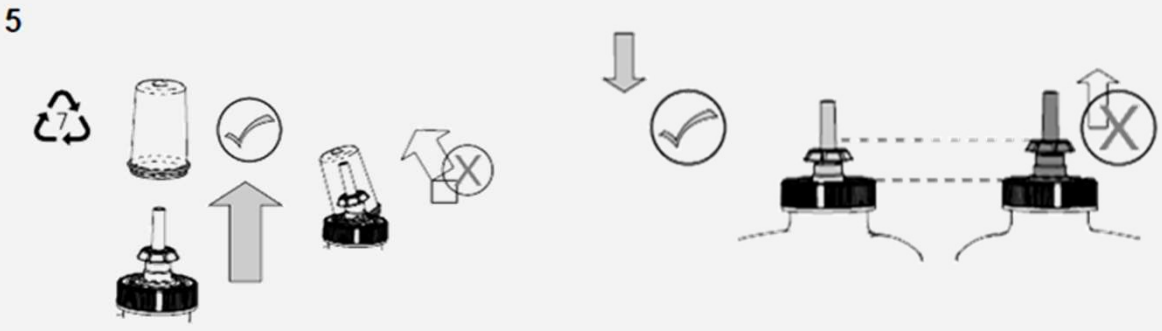


MEDICAL PROCESS S.A.S.
211 av des carrières, Z.I la Plaine du Caire 3 - 13830 Roquefort la Bédoule - FRANCE

# Distributeur de savon / S.H.A / Bétadine

## Notice d'installation et d'entretien
## Commande Electronique

Remplir le distributeur par le dessus

Position fermée

Position ouverte

6

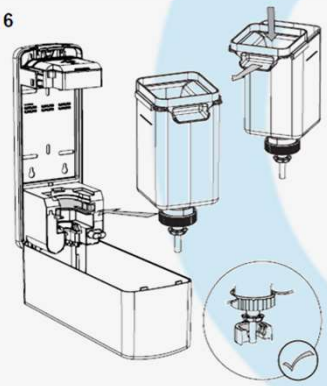

7

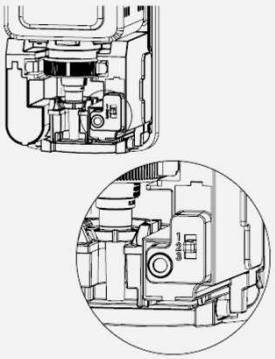

Levier de dosage disponible uniquement sur certains modèles

8




Fermer le distributeur, puis l'amorcer en activant la commande jusqu'à ce que le liquide coule.

### Nettoyage et entretien

- Nettoyer les surfaces extérieures du distributeur à l'aide d'eau tiède et de savon doux.
- NE PAS UTILISER DE DÉTERGENT ABRASIF.
- Sécher à l'aide d'un chiffon doux.

### Explication des lumières L.E.D.

- 1. Rouge = Porte Ouverte
- 2. Vert = En Usage
- 3. Rouge Clignotant = Pile Faible

### Mise en garde

- 1. Il incombe à la personne qui effectue l'installation de l'unité de se conformer à tous les codes, ainsi qu'à toutes les normes et les exigences réglementaires pertinentes.
- 2. N'installez pas ce distributeur au-dessus de sources de chaleur ou près de sources de flammes.
- 3. Ne l'installez pas à un endroit où une défaillance du système de montage ou des fuites du produit sont susceptibles d'occasionner des dommages à l'équipement ou de créer un risque d'accident.

MEDICAL PROCESS S.A.S.
211 av des carrières, Z.I la Plaine du Caire 3 - 13830 Roquefort la Bédoule - FRANCE